



Manual de Marca

VerifAI

A MARCA

Voltada à excelência em saúde, a VerifAI atua como uma plataforma de inspeção visual inteligente para o mercado hospitalar, atendendo diretamente Centrais de Material e Esterilização (CME), fabricantes de dispositivos médicos e serviços de inspeção técnica.

A identidade visual da marca traduz a sua essência: precisão, segurança, confiabilidade e inteligência artificial. O projeto conecta alta tecnologia à inspeção visual, estabelecendo uma linguagem estética moderna e objetiva que transmite solidez em cada ponto de contato.



Marca Principal



VerifAI

Intelligent Visual Inspection

A marca VerifAI representa **precisão, segurança e inteligência artificial** aplicadas à inspeção visual no setor da saúde. Seu símbolo combina a inicial “V” com um elemento central que remete ao foco, análise e confiança.

É moderna, tecnológica e transmite autoridade e confiabilidade.



VERSÕES DA MARCA



A marca VerifAI possui versões horizontais para diferentes aplicações.
Utilize sempre os arquivos oficiais disponíveis para garantir sua integridade e consistência visual.

01

VERSÃO PRINCIPAL

Versão preferencial da marca em aplicações digitais e impressas.



02

MONOCROMÁTICA AZUL

Utilizar em materiais onde apenas uma cor seja permitida e a versão colorida não seja viável.



03

MONOCROMÁTICA PRETA

Utilizar em materiais onde apenas preto seja permitido e a versão colorida não seja viável.



04

VERSÃO NEGATIVA

Utilizar sobre fundos escuros ou em situações em que a versão principal não tenha contraste suficiente.



IMPORTANTE

Sempre que possível, utilize a Versão Principal da marca.
As versões monocromáticas e negativas devem ser usadas apenas quando a versão colorida não for viável ou o contraste não for adequado.



Utilize sempre os arquivos oficiais da marca. Não recrie ou modifique os elementos.



VERSÕES DA MARCA



A marca VerifAI possui versões verticais para diferentes aplicações.

Utilize sempre os arquivos oficiais disponíveis para garantir sua integridade e consistência visual.

01

VERSÃO PRINCIPAL

Versão preferencial da marca em aplicações digitais e impressas.



02

MONOCROMÁTICA AZUL

Utilizar em materiais onde apenas uma cor seja permitida e a versão colorida não seja viável.



03

MONOCROMÁTICA PRETA

Utilizar em materiais onde apenas preto seja permitido e a versão colorida não seja viável.



04

VERSÃO NEGATIVA

Utilizar sobre fundos escuros ou em situações em que a versão principal não tenha contraste suficiente.



IMPORTANTE

Sempre que possível, utilize a Versão Principal da marca.

As versões monocromáticas e negativas devem ser usadas apenas quando a versão colorida não for viável ou o contraste não for adequado.



Utilize sempre os arquivos oficiais da marca. Não recrie ou modifique os elementos.



O SÍMBOLO

A construção do símbolo da VerifAI nasce da união entre a inicial 'V' e o ícone de check, criando uma assinatura visual que materializa a **validação**, a **precisão** e a **segurança** do sistema.


O elemento central atua como o cérebro da plataforma, fazendo referência direta à análise avançada realizada por **inteligência artificial**. Toda a geometria do símbolo, aliada à sobriedade dos tons de azul, foi projetada para consolidar uma imagem de **confiança** e **inovação** sob medida para o setor médico-hospitalar.



PALETA DE CORES



A paleta cromática da VerifAI combina tons de azul e ciano associados à **tecnologia, precisão e confiança**. O azul profundo atua como cor predominante da identidade, enquanto o azul tecnológico e o ciano funcionam como cores de apoio e destaque, proporcionando contraste e legibilidade em aplicações digitais e institucionais.

 AZUL PROFUNDO #191930	 AZUL TECNOLÓGICO #3059A5	 CIANO #35B5DA
RGB 25 25 48	RGB 48 89 165	RGB 53 181 218
CMYK 93 88 50 65	CMYK 90 69 0 0	CMYK 68 5 8 0

PROPORÇÃO DE USO DA PALETA



● **AZUL PROFUNDO**
Cor predominante

● **AZUL TECNOLÓGICO**
Cor de apoio

● **CIANO**
Cor de destaque



TIPOGRAFIA

A tipografia institucional da VerifAI foi escolhida para transmitir **tecnologia, precisão e confiança**. A família **Inter** é moderna, clara e altamente legível, garantindo consistência e eficiência em todas as comunicações.

Aa

POR QUE INTER?



Alta legibilidade

Clareza em diferentes tamanhos e dispositivos.



Versatilidade

Perfeita para aplicações digitais e impressas.



Personalidade técnica

Transmite inovação, confiança e precisão.

DIRETRIZES DE USO

T

Use pesos mais fortes (Semi Bold, Bold) em títulos e destaques para criar hierarquia e garantir impacto visual.

Aa

Para textos corridos, utilize Regular ou Medium para garantir conforto e legibilidade.



Mantenha contraste adequado entre texto e fundo para assegurar acessibilidade e clareza em todos os meios.



Evite o uso excessivo de variações tipográficas. A consistência fortalece a identidade da marca.

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA

Inter

Fonte sans-serif geométrica e minimalista, desenvolvida para interfaces digitais e leitura em tela.

Light

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Regular

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Medium

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Semi Bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Extra Bold

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

APLICAÇÃO TIPOGRÁFICA

TÍTULOS (H1)

Inspeção visual inteligente com IA.

Inter Bold • Tamanho sugerido: 40/48px

SUBTÍTULOS (H2)

Precisão e segurança em cada detalhe da inspeção.

Inter Semi Bold • Tamanho sugerido: 24/28px

CORPO DE TEXTO

A VerifAI utiliza inteligência artificial para identificar falhas e garantir conformidade com os mais altos padrões de qualidade.

Inter Regular • Tamanho sugerido: 14/20px

USO INCORRETO



VerifAI

Intelligent Visual Inspection

Para manter a integridade e o reconhecimento da marca VerifAI, **é fundamental respeitar as diretrizes de aplicação**. Evite qualquer modificação que comprometa sua legibilidade, proporção e consistência visual.

❌ 01. NÃO ALTERAR AS CORES

Não utilize cores diferentes das especificadas.



❌ 02. NÃO ALTERAR A TIPOGRAFIA

Não substitua ou modifique a tipografia da marca.



❌ 03. NÃO DISTORCER A MARCA

Não estique, compacte ou distorça a marca.



❌ 04. NÃO ALTERAR A PROPORÇÃO

Não modifique a relação de tamanho entre símbolo e logotipo.



❌ 05. NÃO INCLINAR OU ROTACIONAR

Não incline ou rotacione a marca.



❌ 06. NÃO APLICAR EFEITOS

Não use sombras, contornos, gradientes ou outros efeitos.



❌ 07. NÃO ALTERAR A DISPOSIÇÃO

Não reorganize os elementos ou crie composições diferentes.



❌ 08. NÃO USAR SOBRE FUNDOS INADEQUADOS

Não aplique a marca sobre fundos que comprometam a sua legibilidade.



❌ 09. NÃO CONTORNAR A MARCA

Não adicione contornos ou molduras.



❌ 10. NÃO UTILIZAR TRANSPARÊNCIA

Não reduza a opacidade da marca.



IMPORTANTE

O uso incorreto da marca pode enfraquecer sua identidade, reduzir o reconhecimento e comprometer a confiança do público. Em caso de dúvidas, siga sempre este manual.



A consistência fortalece a confiança. A marca é o reflexo da qualidade.



ÁREA DE PROTEÇÃO

A área de proteção define o espaço mínimo que deve ser mantido ao redor da marca VerifAI, isolando-a de outros elementos gráficos, textos, imagens ou bordas.

Esse espaço garante a integridade, legibilidade e o impacto visual da marca em todas as aplicações.



A unidade "X" utilizada como medida de proteção corresponde à altura do símbolo da marca.



APLICAÇÃO HORIZONTAL



APLICAÇÃO VERTICAL



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Respeite sempre a área de proteção mínima definida.
- ✓ Não posicione textos, imagens ou elementos gráficos dentro dessa área.
- ✓ Em materiais digitais ou impressos, mantenha o respiro da marca para garantir clareza e destaque.



Exemplo de aplicação correta, respeitando toda a área de proteção da marca.

[Soluções](#)[Tecnologia](#)[Recursos](#)[Sobre nós](#)[Contato](#)[Fale conosco](#)

Inspeção visual inteligente. Resultados confiáveis.

A VerifAI utiliza inteligência artificial para transformar inspeções em processos mais rápidos, precisos e seguros na área da saúde.

[Conheça nossas soluções →](#)

Precisão

Deteção avançada com algoritmos de IA.



Agilidade

Inspeções mais rápidas e eficientes.




Segurança

Mais confiabilidade para sua operação.



Rastreabilidade

Dados completos para decisões assertivas.

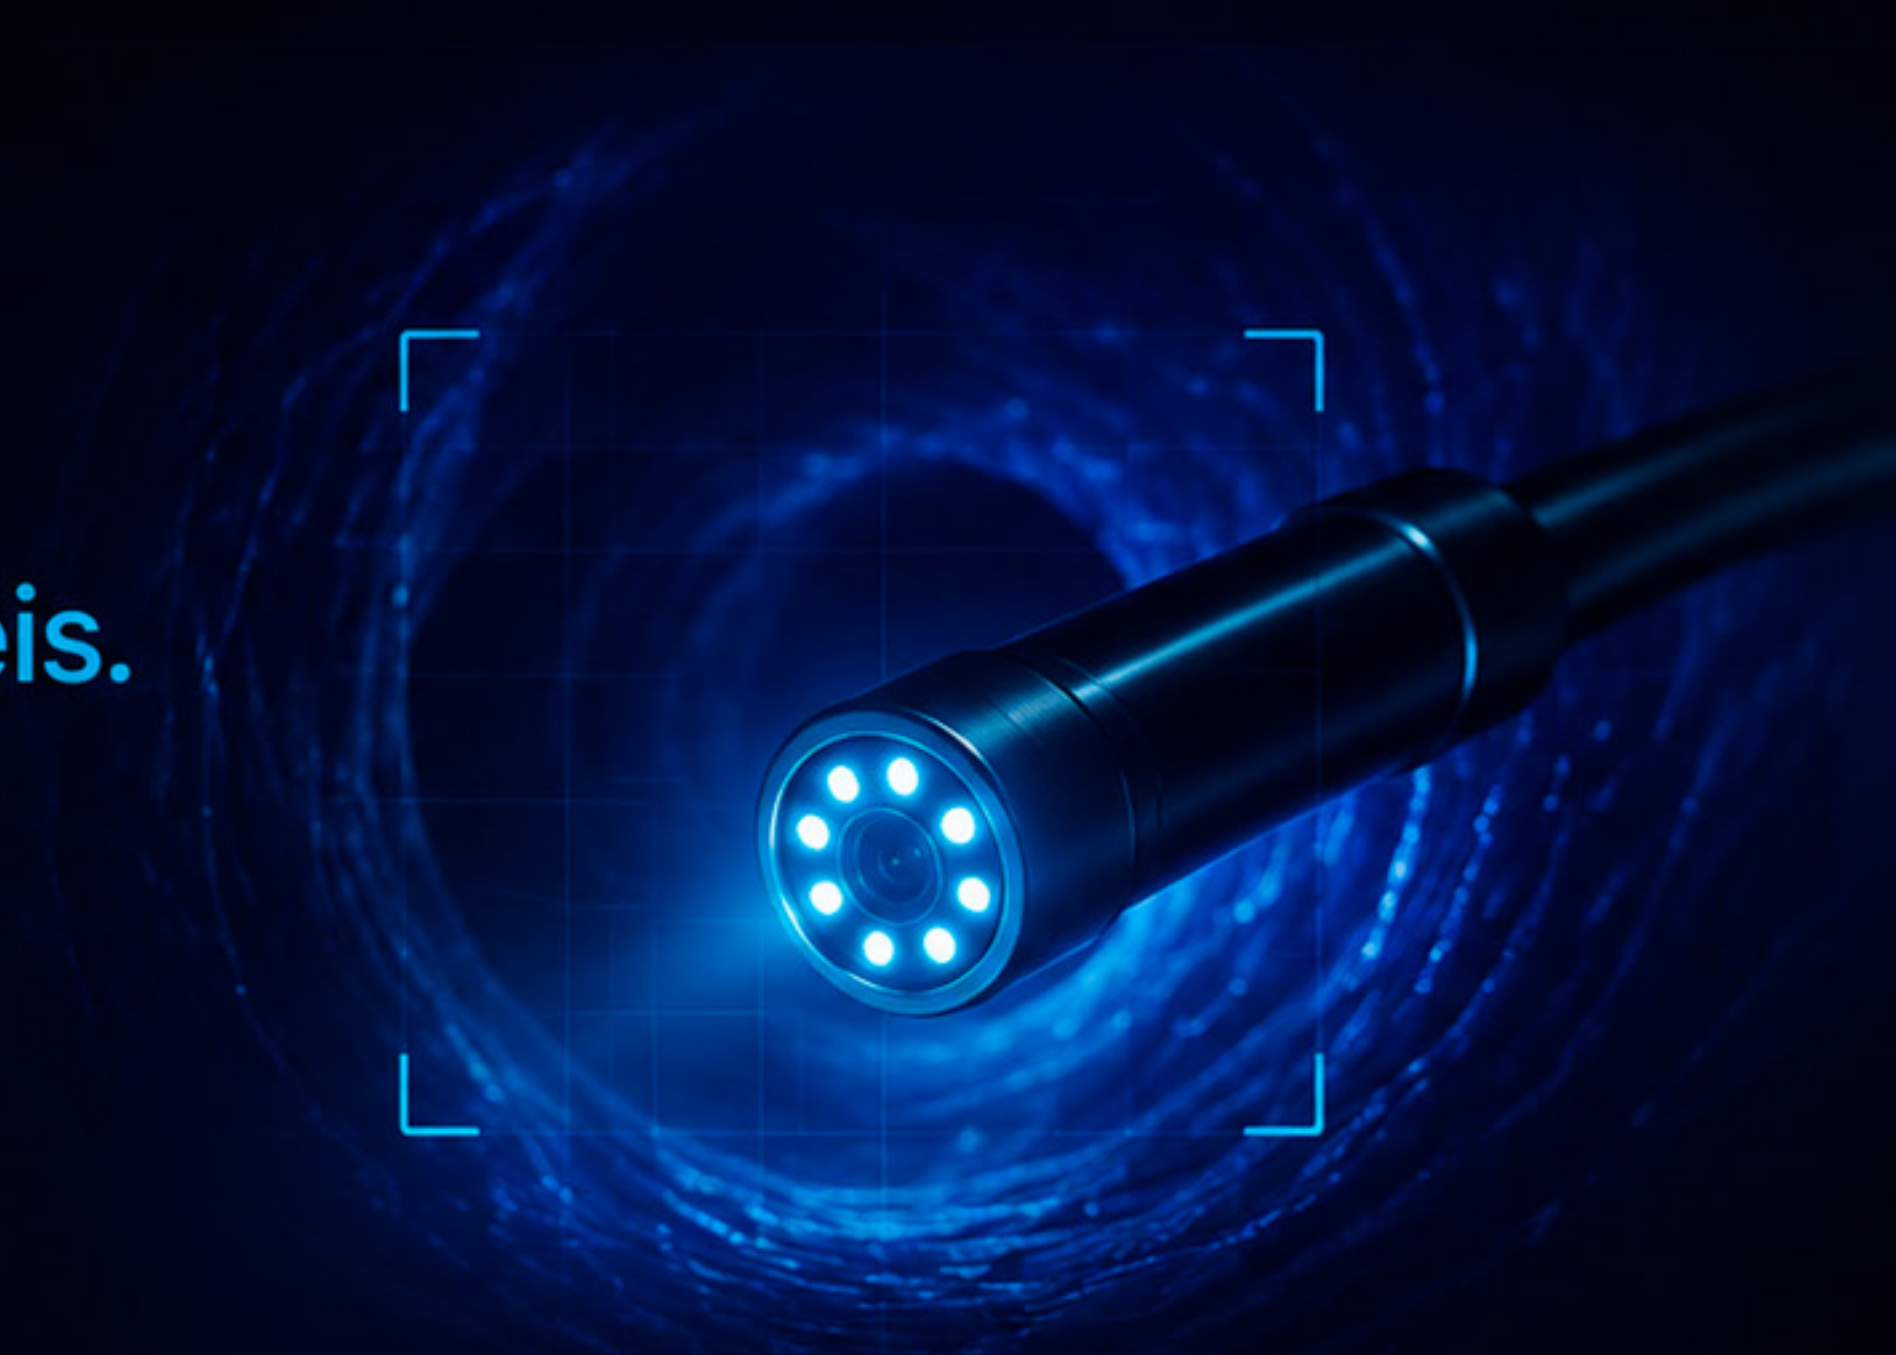



Inspeção visual inteligente na palma da sua mão.



Segurança

Dados protegidos e em conformidade com os mais altos padrões.




Agilidade

Inspeções mais rápidas e eficientes com IA.



Rastreabilidade

Histórico completo e relatórios automatizados.



Inteligência Artificial

Deteção automática de anomalias com alta precisão.



RESULTADO DA INSPEÇÃO



APROVADO

Nenhuma anomalia detectada.

DATA DA INSPEÇÃO
07/05/2026 - 09:15


RESPONSÁVEL
Ana Carolina

MÉTODO
Inspeção visual assistida por IA

EQUIPAMENTO UTILIZADO
Endoscópio Flexível EX500
ID: ED-04539

NÚMERO DE SÉRIE
EX500-789452

IMAGEM INSPECIONADA

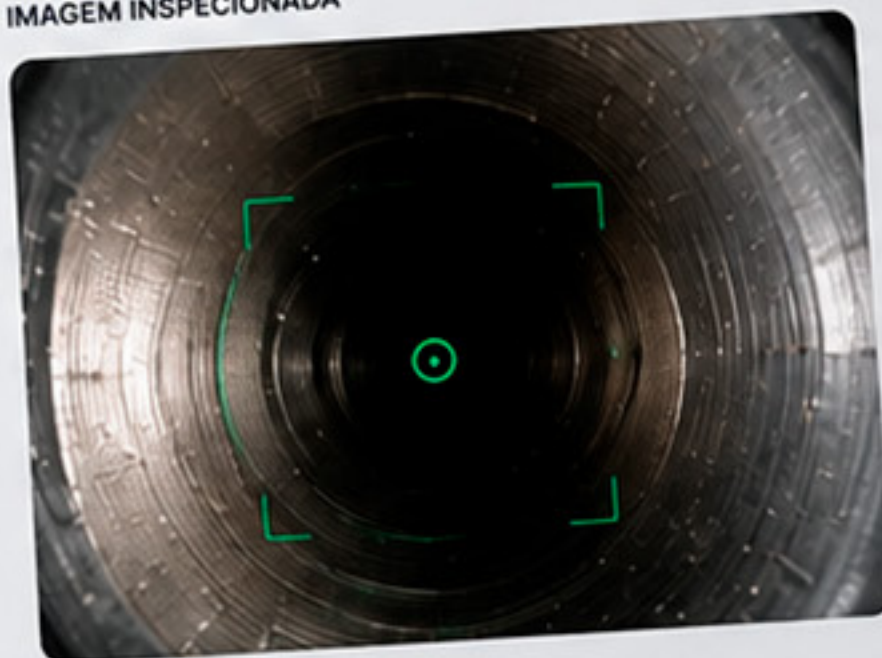

RESUMO DA INSPEÇÃO

Inspeção realizada com sucesso. Não foram identificadas não conformidades.
O equipamento está apto para uso.

DETALHES DA INSPEÇÃO

Componente inspecionado	Canal de trabalho
Tipo de inspeção	Preventiva
Duração	00:02:34
Profundidade de inserção	120 cm
Operador	Ana Carolina
Versão do software	VerifAI v2.3.1

IMAGENS CAPTURADAS



Ver todas as imagens no sistema [VerifAI](#)

RESULTADO DA INSPEÇÃO




APROVADO

Nenhuma anomalia detectada.

DATA DA INSPEÇÃO
07/05/2026 - 09:15

RESPONSÁVEL
Ana Carolina

IMAGEM INSPECIONADA

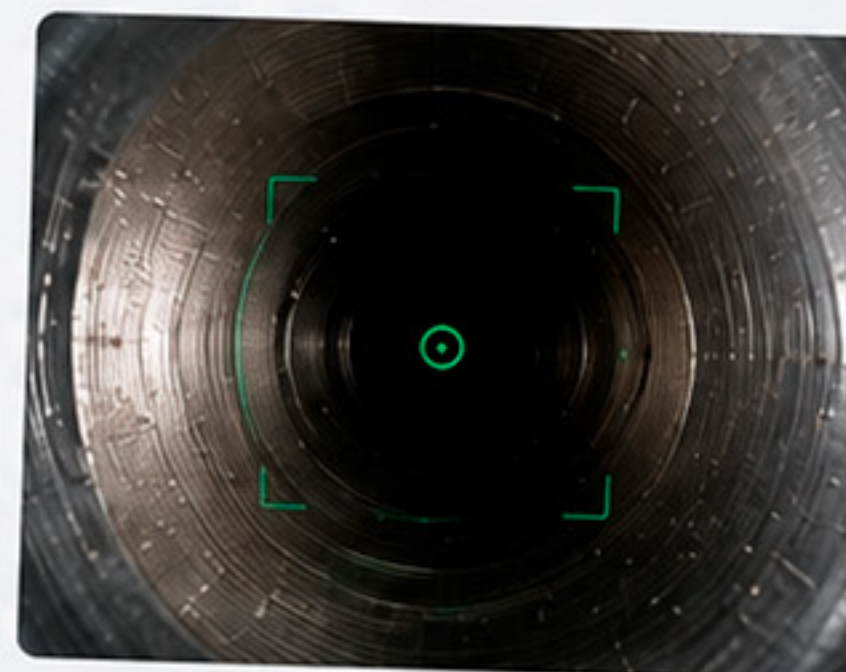


-  Equipamento
Endoscópio Flexível EX500
-  ID do equipamento
ED-04539
-  Número de série
EX500-789452
-  Método
Inspeção visual assistida por IA
-  Versão do software
VerifAI v2.3.1

RESUMO DA INSPEÇÃO

Inspeção realizada com sucesso. Não foram identificadas não conformidades.
O equipamento está apto para uso.

IMAGENS CAPTURADAS

[Ver todas](#)

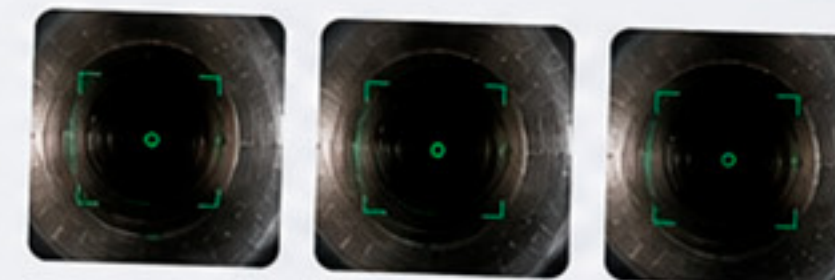


Rastreabilidade garantida

Todos os dados desta inspeção estão armazenados com segurança
e disponíveis para auditoria.



Verifique a autenticidade
Escaneie o QR Code para validar
este relatório no sistema VerifAI.

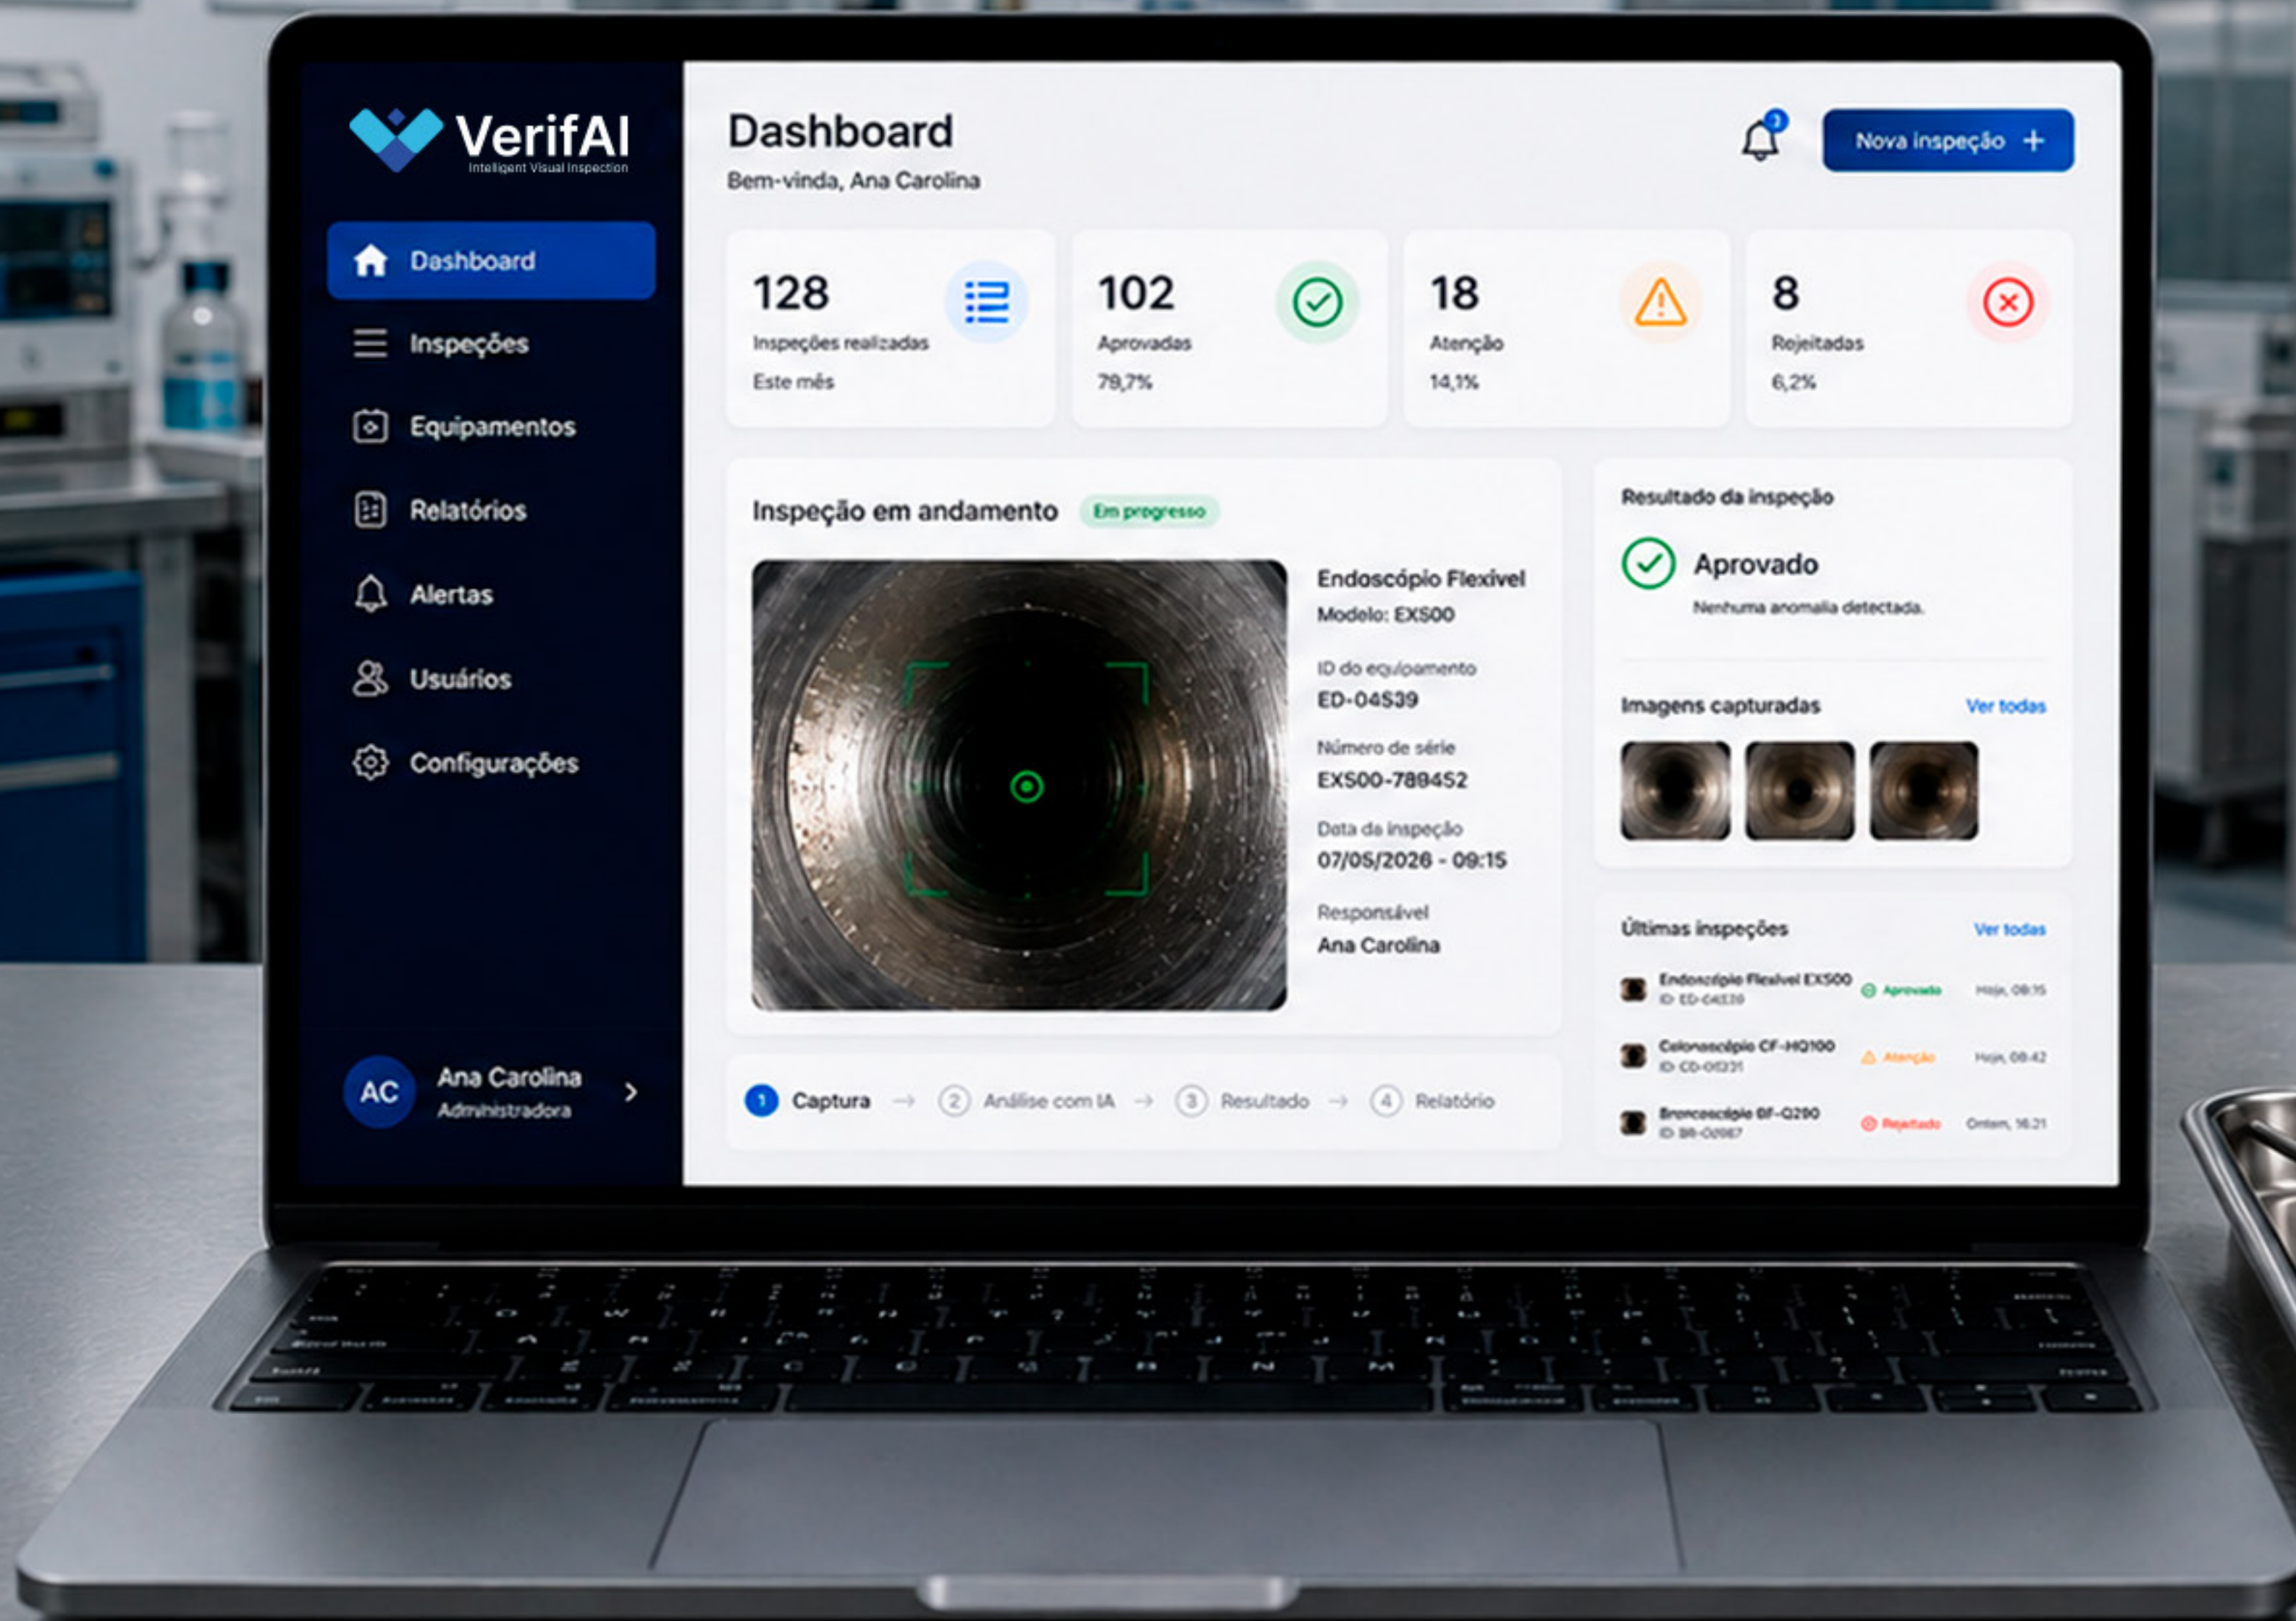

Dashboard

Inspeções

Equipamentos

Relatórios

Alertas

Usuários

Configurações

AC Ana Carolina Administradora

Dashboard

Bem-vinda, Ana Carolina

128

Inspeções realizadas
Este mês



102

Aprovadas
79,7%



18

Atenção
14,1%




8

Rejeitadas
6,2%



Inspeção em andamento Em progresso

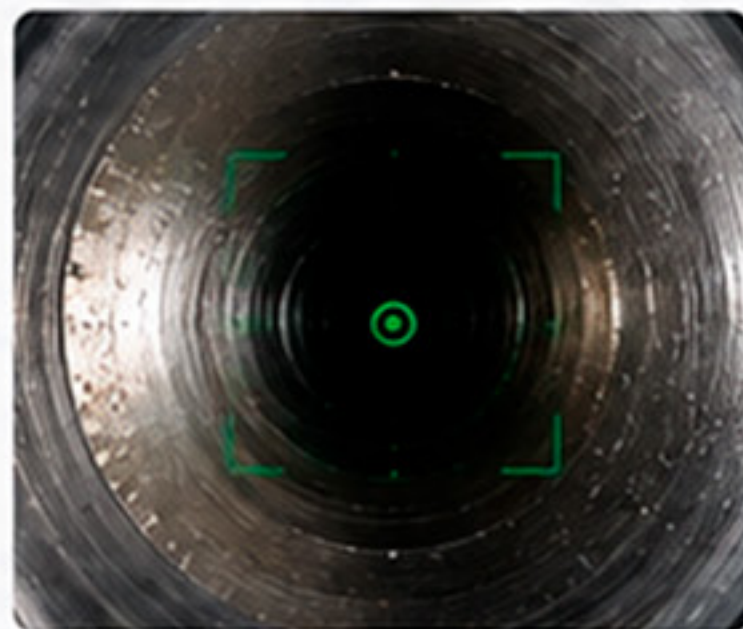

Endoscópio Flexível
Modelo: EX500

ID do equipamento
ED-04539

Número de série
EX500-788452

Data da inspeção
07/05/2026 - 09:15

Responsável
Ana Carolina

1 Captura → 2 Análise com IA → 3 Resultado → 4 Relatório

Resultado da inspeção




Aprovado

Nenhuma anomalia detectada.

Imagens capturadas

[Ver todas](#)

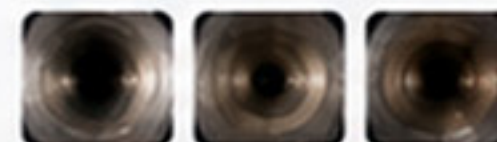

Últimas inspeções

[Ver todas](#)

Endoscópio Flexível EX500 ID: ED-04539	Aprovado	Hoje, 09:15
Colonoscópio CF-HQ100 ID: CD-01231	Atenção	Hoje, 09:42
Broncoscópio BF-Q290 ID: BR-00987	Rejeitado	Ontem, 16:21



Rastreabilidade e segurança em **cada detalhe.**



Identificação única

Cada equipamento com código exclusivo.



Acesso rápido

Escaneie o QR Code e tenha acesso imediata ao histórico.



Mais segurança

Dados protegidos e em conformidade com os mais altos padrões.



Controle total

Gestão completa do seu patrimônio e inspeções.



VerifAI
Intelligent Visual Inspection